
	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ0D00AZ
---	---	----------


### TGA CAL Set

**REF** 50 063 45

**LOT** 0D12B00

 2015 – 06 – 30

#### 1. Packungsinhalt / Package content

Inhalt/ Content	Reagenz/reagent	LOT		<input checked="" type="checkbox"/> JA/YES <input type="checkbox"/> NEIN/NO
1 x 3 ml	TGA BUF [1]	9P01B01	31.12.2015	<input type="checkbox"/> NEIN/NO
1 x 0,5ml	TGA Thrombin Calibrator	5T13B00	30.06.2015	<input checked="" type="checkbox"/> JA/YES <input type="checkbox"/> NEIN/NO



#### **Freigabekriterium / Requirements:**

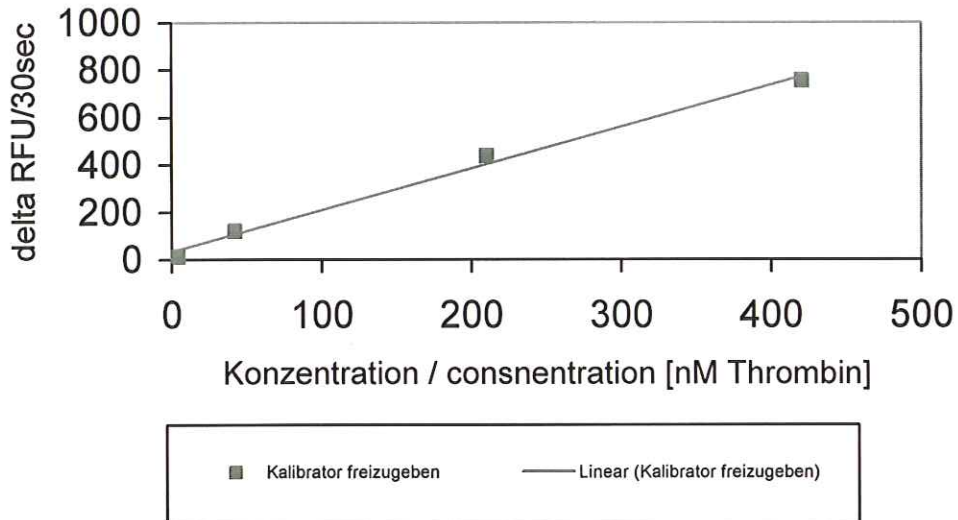
Die Packung muss 1 x 3 ml TGA BUF [1], 1 x 0,5 ml TGA Thrombin Standard enthalten.  
The package should contain 1 x 3 ml TGA BUF [1], 1 x 0,5 ml TGA Thrombin standard.

#### 2. Verwendbarkeit / Usability

#### **Ergebnisse / Results:**

1:2 Verdünnung – delta RFU mit bereits freigegebenem Lot: RFU 755,0  
1:2 dilution – delta RFU of the already released batch:

DQ0T00.01  27.10.11	Seite 1 / 2 page	PP/ 554 / 11  27.10.11
--	---------------------	---



**Freigabekriterien / Requirements:**

Die 1:2 Verdünnung der Standardkurve muss  $\geq 200$  RFU aufweisen.

The 1:2 Dilution of the calibration curve must be  $\geq 200$  RFU.

Herstelldatum/ Date of manufacturing: 26.09.2011

Das TGA CAL Set, **LOT** 0D12B00 wird freigegeben.

The TGA CAL Set, **LOT** 0D12B00, is released.